



Bedienungsanleitung

Schnelles ALMEMO® Messmodul für Spannung, Strom und Leistung

Spannung DC ZED7 00-ABx

Strom DC ZED7 01-ABx

Leistung DC ZED7 07-ABxy

Spannung AC ZED7 30-ABx

Strom AC ZED7 31-Abx

Leistung AC ZED7 37-ABxy

D7-Technologie

Deutsch

V 2.7

25.10.2022

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Symbolerklärung	4
3	Sicherheitshinweise	5
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
4	Produkt	7
4.1	Lieferumfang	7
4.2	Beschreibung Messmodul	8
4.3	Artikelnummern und Messbereiche des Messmoduls bei Auslieferung	9
4.4	Beschreibung Steckdosenadapter	11
4.5	Digitale ALMEMO® D7-Messfühler	11
4.6	Betrieb als Fühler an ALMEMO® V7-Messgeräten	11
4.7	Messwertkorrektur	12
4.8	Sensormenü	13
4.9	Konfiguration am PC über USB-Adapterkabel	13
5	Messungen mit dem Messmodul durchführen	15
5.1	Spannung DC mit dem Modul ZED7 00-ABx messen	15
5.2	Stromstärke DC mit dem Modul ZED7 01-ABx messen	16
5.3	Leistung DC mit dem Modul ZED7 07-ABxy messen	17
5.4	Spannung AC mit dem Modul ZED7 30-ABx messen	18
5.5	Stromstärke AC mit dem Modul ZED7 31-ABy messen	19
5.6	Leistung AC mit dem Modul ZED7 37-ABxy messen	21
6	Steckdosenadapter nutzen	23
6.1	Spannungsmessung mit Steckdosenadapter	23
6.2	Stromstärkenmessung mit Steckdosenadapter	24
6.3	Leistungsmessung mit Steckdosenadapter	24
7	Wartung und Pflege	26

8 Gewährleistung	27
9 Entsorgung	28
10 Technische Daten	29

2 Symbolerklärung



Sicherheitshinweis

!

Voraussetzung

→

Aufforderung



Hinweis



Resultat

Zurück Text, der in einer Software angezeigt wird

3 Sicherheitshinweise

- Die Messmodule sind je nach Typ dazu geeignet, Spannungen, Ströme und Leistung, bei Potentialen über 50V zu messen. Bei Betrieb und besonders beim Anschluss des Messmoduls und des Steckdosenadapters ist sorgfältig darauf zu achten, dass keine hochspannungsführenden Teile berührt werden.
- Verwenden Sie für den Anschluss der Messmodule für AC/DC-Signale und für den Anschluss des Steckdosenadapters die mitgelieferten oder gleichwertige berührungsgeschützte Anschlusskabel.
- Das Messmodul für DC-Signale darf nur mit Gleichspannung bzw. Gleichstrom gemäß dem auf dem Typenschild angegebenen Messbereich betrieben werden.
- Achten Sie besonders darauf, dass die Strommodule immer in Reihe zum Verbraucher, d.h. in eine Zuleitung, geschaltet werden und nicht unmittelbar an die Spannungsquelle angeschlossen werden dürfen. Bei Verwendung des Steckdosenadapters sind die zugehörigen Buchsen von Steckdosenadapter und Messmodul (A-A, V-V, COM-COM) miteinander zu verbinden. Die Farbe der Buchsen ist hier zu beachten.
- Messgerät und Messmodul sowie der Steckdosenadapter dürfen nicht in nasser oder feuchter Umgebung betrieben werden.
- Das Kunststoffgehäuse ist vor offenem Feuer und heißen Oberflächen (z.B. Herdplatten) zu schützen.
- Das Messmodul und der Steckdosenadapter dürfen nicht mehr verwendet werden, wenn sie äußerlich beschädigt sind oder evtl. nach einem falschen Anschluss nicht mehr funktionieren.
- Werden Messmodul oder Steckdosenadapter zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Die Schutzfunktion von Messmodul und Steckdosenadapter wird beeinträchtigt, wenn die Geräte in einer vom Hersteller nicht festgelegten Weise benutzt wird.
- Der Messmodul-interne Strommesspfad ist bei Strömen größer als 10A nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Eine Messung darf in diesem Fall maximal für die Dauer von 10 Minuten durchgeführt werden. Danach muss eine Abkühlung des Gerätes auf Raumtemperatur erfolgen.

3 Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Steckdosenadapter nur für die Dauer der eigentlichen Messung.

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Schnelle ALMEMO® Messmodul für Spannung, Strom und Leistung wird zur Messung von Strom- und Spannungssignalen verwendet. Diese sind Spannung DC, Stromstärke DC, Leistung DC, Spannung AC, Stromstärke AC und Frequenz. Aus diesen Signalen wird die Wirkleistung inklusive Leistungsfaktor berechnet. Das Messmodul ist geeignet für Spannungsmessungen bis 400V (DC) und 400V_{eff} (AC) sowie Strommessungen bis 20A (DC) bzw. 20A_{eff} (AC).

Der Steckdosenadapter dient als Hilfsmittel zur Messung von Spannung, Strom und Leistung an Stromkreisen, die elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (CAT II). Der Steckdosenadapter ist ausschließlich für den Betrieb mit dem Messmodul zu verwenden. Andere Betriebsarten sind nicht zugelassen.

4 Produkt

4.1 Lieferumfang

→ Achten Sie beim Auspacken auf Beschädigungen des Lieferinhaltes und die Vollständigkeit der Lieferung.

☞ Die genaue Zusammenstellung der Lieferung hängt von Ihrer Bestellung ab.

Messmodul für

Spannung DC	ZED7 00-ABx
Strom DC	ZED7 01-ABx
Leistung DC	ZED7 07-ABxy
Spannung AC	ZED7 30-ABx
Strom AC	ZED7 31-ABy
Leistung AC	ZED7 37-ABxy




Anschlusskabel

Messleitung CAT III mit beidseitigem Sicherheitsstecker

Optional erhältlich:

Steckdosenadapter inklusive Kurzschlussbrücke

ZE 2000-PA



Diese Bedienungsanleitung

- Im Falle eines Transportschadens ist das Verpackungsmaterial aufzubewahren und der Lieferant umgehend zu informieren.
- Bei Verwendung von Zubehör, das nicht der CAT III (500 V) Kategorie entspricht, sinkt die Messkategorie auf den niedrigsten Wert der resultierenden Kombination aus Zubehör und Messmodul.

4.2 Beschreibung Messmodul

Die ALMEMO® AC-Messmodule ZED7 30-ABx, ZED7 31-ABy und ZED7 37-ABxy erfassen den Echt-Effektivwert einer Wechselstrom- und/oder Wechselspannungsgröße. Das heißt das Messsignal mit beliebiger Kurvenform wird mit 1kHz digitalisiert und der echte Effektivwert berechnet und am Messgerät angezeigt.

Bei den Messmodulen ZED7 37-ABxy werden sowohl der Wechselstrom als auch die Spannung synchron gemessen und daraus die Wirkleistung und der Leistungsfaktor ermittelt. Die Übertragung der Daten zum Messgerät erfolgt digital.

Das Messmodul ist mit 6 kV galvanisch getrennt und überspannungsgesichert. Dieses kann an jeden Messeingang eines beliebigen ALMEMO® Messgerätes der Geräteversion V7 angesteckt werden. Es können auch mehrere Messmodule an ein Messgerät angesteckt werden.

Die Stromversorgung des Messmoduls erfolgt durch das ALMEMO® Messgerät über einen DC/DC-Wandler (Isolationsspannung 6 kV). Die Stromversorgung des Messgerätes wird mit ca. 40 mA belastet, d.h. für einen Langzeitbetrieb ist ein Netzadapter erforderlich.

Echt-Effektivwert-Messung

Das Wechselspannungssignal wird laufend mit 1kHz abgetastet und der Gesamteffektivwert aus Gleich- und Wechselspannungsanteil berechnet.

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{V_{\text{AC}}^2 + V_{\text{DC}}^2}$$

4.3 Artikelnummern und Messbereiche des Messmoduls bei Auslieferung

Bezeichnung	Ausführung DC	Bereich	Messbereich	Dim.	Auflösung
ZED7 00-AB3 1. U60.00	Spannung 60V DC	B-01 D U602	-62.00...+62.00.	V	0.01 V
ZED7 00-AB5 1. U400.0	Spannung 400V DC	B-02 D U4001	-440.0 ...+440.0	V	0.1 V
ZED7 01-AB1 1.I20.00mA	Strom 20 mA DC	B-03 D I202	-22.00... +22.00	mA	1 mA
ZED7 01-AB2 1. I200.0mA	Strom 200 mA DC	B-04 D I2001	-220.0... +220.0	mA	1 mA
ZED7 01-AB3 1. I2.000A	Strom 2 A DC	B-05 D I23	-2.200... +2.200	A	0.001 A
ZED7 01-AB5 1. I20.00A	Strom 20 A DC	B-06 D I202	-22.00 ...+22.00	A	0.01A
ZED7 07-AB33 1. U60.00 2. I2.000A 3. P120.0W	Leistung 60V DC 2 A DC 120W DC	B-01 D U602 B-05 D I23 B-07 D P1201	-62.00 ...+62.00. -2.200... +2.200 0.0 ... 125.0	V A W	0.01 V 0.001 A 0.1 W
ZED7 07-AB35 1. U60.00 2. I20.00A 3. P1200W	Leistung 60V DC 20 A DC 1.2 kW DC	B-01 D U602 B-06 D I202 B-08 D P122	-62.00 ...+62.00. -22.00 ...+22.00 0.0 ... 1.250	V A kW	0.01 V 0.01A 0.001 kW
ZED7 07-AB53 1. U400.0 2. I2.000A 3. P800W	Leistung 400V DC 2 A DC 800W DC	B-02 D U4001 B-05 D I23 B-09 D P8001	-440.0 ...+440.0 -2.200 ... +2.200 0.0 ... 820.0	V A W	0.1 V 0.001 A 0.1 W
ZED7 07-AB55 1. U400.0 2. I20.00A 3. P8000W	Leistung 400V DC 20 A DC 8 kW DC	B-02 D U4001 B-06 D I202 B-10 D P82	-440.0 ...+440.0 -22.00 ...+22.00 0.00 ... 8.20	V A kW	0.1 V 0.01A 0.01 kW


4 Produkt

	AC				
ZED7 30-AB3	Spannung				
1. U25.00	25 V _{eff}	B-01 D U252	0,00 ... 27.00	V _{eff}	0.01 V _{eff}
2. FREQ	250 Hz	B-08 D F32	20.00 ... 250.00	Hz	0.01 Hz
ZED7 30-AB5	Spannung				
1. U400.0	400 V _{eff}	B-02 D U4001	0.0 ... 440.0	V _{eff}	0.1 V _{eff}
2. FREQ	250 Hz	B-08 D F32	20.00 ... 250.00	Hz	0.01 Hz
ZED7 31-AB1	Strom				
1. I1.800	1,8 A _{eff}	B-03 D I23	0.000 ... 2.000	A _{eff}	0.001 A _{eff}
2. FREQ	250 Hz	B-08 D F32	20.00 ... 250.00	Hz	0.01 Hz
ZED7 31-AB3	Strom				
1. I20.00	20 A _{eff}	B-04 D I202	0.00 ... 22.00	A _{eff}	0.01 A _{eff}
2. FREQ	250 Hz	B-08 D F32	20.00 ... 250.00	Hz	0.01 Hz
ZED7 37-AB31	Leistung				
1. U25.00	25 V _{eff}	B-01 D U252	0,00 ... 27.00	V _{eff}	0.01 V _{eff}
2. I1.800	1,8 A _{eff}	B-03 D I23	0.000 ... 2.000	A _{eff}	0.001 A _{eff}
3. P50.0	45 W	B-05 D P501	0.0 ... 50.0 W	W	0.1 W
4. FREQ	250 Hz	B-08 D F32	20.00 ... 250.00	Hz	0.01 Hz
5. LF		B-09 D LF	-0.99 ... +1.00		0.01
ZED7 37-AB51	Leistung				
1. U400.0	400 V _{eff}	B-02 D U4001	0.0 ... 440.0	V _{eff}	0.1 V _{eff}
2. I1.800	1,8 A _{eff}	B-03 D I23	0.000 ... 2.000	A _{eff}	0.001 A _{eff}
3. P800	720 W	B-05 D P800	0 ... 800 W	W	1 W
4. FREQ	250 Hz	B-08 D F32	20.00... 250.00	Hz	0.01 Hz
5. LF		B-09 D LF	-0.99 ... +1.00		0.01
ZED7 37-AB53	Leistung				
1. U400.0	400 V _{eff}	B-02 D U4001	0.0 ... 440.0	V _{eff}	0.1 V _{eff}
2. I20.00	20 A _{eff}	B-04 D I202	0.00 ... 22.00	A _{eff}	0.01 A _{eff}
3. P8000	8 KW	B-07 D P82	0.00 ... 8.00	kW	0.01 kW
4. FREQ	250 Hz	B-08 D F32	20.00... 250.00	Hz	0.01 Hz
5. LF		B-09 D LF	-0.99 ... +1.00		0.01

4.4 Beschreibung Steckdosenadapter

Der Steckdosenadapter mit der Artikelnummer ZE 2000-PA ist optional lieferbar. Er ist als sicheres Hilfsmittel zur Messung von Spannung, Strom und Leistung an Stromkreisen, die elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (CAT II) vorgesehen.

Die Kurzschlussbrücke ist aus Sicherheitsgründen nur an die schwarze Buchse (COM) und die blaue Buchse (A) anschließbar und kommt nur zum Einsatz, wenn keine Strommessung erforderlich ist und der Stromkreis lediglich geschlossen werden soll.

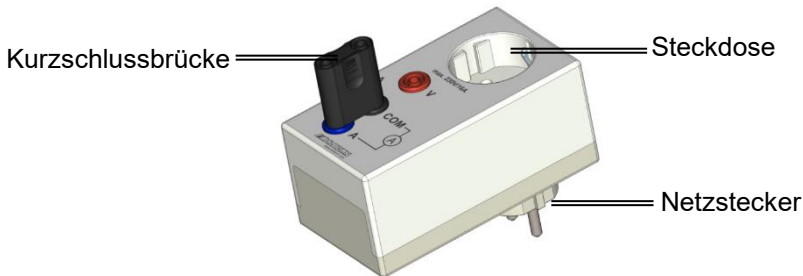

4.5 Digitale ALMEMO® D7-Messfühler


Aufbauend auf den bereits autarken ALMEMO®-D6-Steckern mit serieller Schnittstelle wurden die Möglichkeiten der Unabhängigkeit vom Messgerät konsequent weiterentwickelt und ein ganz neues V7-Messsystem geschaffen. Dabei ist eine effiziente Messung schneller und langsamer Fühler mit beliebigem Messwertumfang gleichzeitig möglich. Neue Messfunktionen und Bereiche, die von den ALMEMO® Geräten selbst nicht unterstützt werden, können über ein im Fühler gespeichertes Menü konfiguriert und genutzt werden. Dies macht das neue ALMEMO® V7-System unvergleichlich flexibel und zukunftsfähig. Die Kommunikation von Fühler zu Messgerät erfolgt generell über eine serielle Schnittstelle. Damit lassen sich die D7-Fühler nur noch an neue ALMEMO® V7-Geräte anschließen.

4.6 Betrieb als Fühler an ALMEMO® V7-Messgeräten


ALMEMO® D7-Fühler liefern ihre endgültigen digitalen Messwerte von 1 bis 10 Messkanälen über die serielle Schnittstelle an das ALMEMO® V7-Gerät, die dort lediglich gespeichert oder ausgegeben werden. Funktionskanäle sind nur vom

4 Produkt

Gerät programmier- und nutzbar. Soll ein Messkanal nicht angezeigt werden, kann der Messbereich wie üblich über das ALMEMO® Gerät deaktiviert und auch wieder aktiviert werden. Die Versorgung des Fühlers erfolgt über das Messgerät.

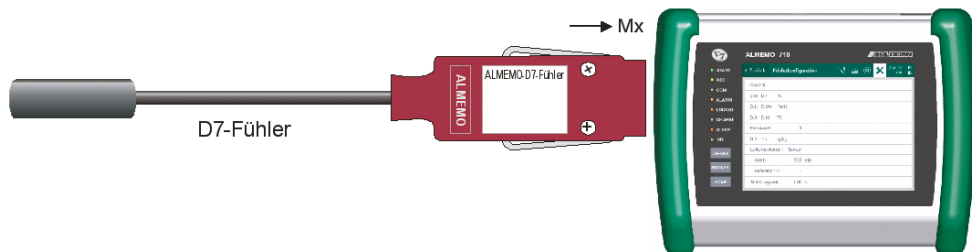

Verlängerung

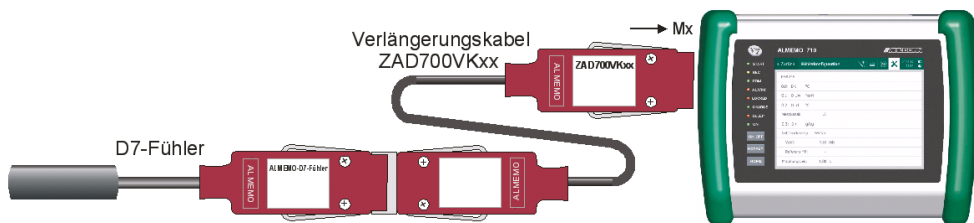


Zur Verlängerung der Fühler am Gerät dienen die Verlängerungskabel ZAD7 00-VKxx, bei denen die Messwerte und die Steckerprogrammierung seriell störsticher über RS422-Treiber übertragen werden. Zur galvanischen Trennung gibt es zusätzlich ein kleines Adapterkabel ZAD7 00-GT.

4.7 Messwertkorrektur

Für die Primärmesskanäle können Abgleichwerte oder eine Mehrpunktjustage im D7-Fühler abgelegt werden (ab Werk oder über V7-Messgerät mit Option KL). Korrekturwerte (Nullpunkt, Steigung, Basis, Faktor) werden bereits im Fühler verarbeitet.


4.8 Sensormenü

Um die Zukunftsfähigkeit des neuen ALMEMO® V7-Messsystems auf lange Jahre ohne Änderung des Messgerätes zu erhalten, besitzt jeder D7-Fühler ein individuelles Sensormenü, das über jedes ALMEMO® V7 Messgerät aufrufbar ist. So ist es möglich Messbereiche oder andere spezifische Fühlerfunktionen zu konfigurieren. Als Bediengerät kann ein V7-Messgerät oder auch ein PC dienen.

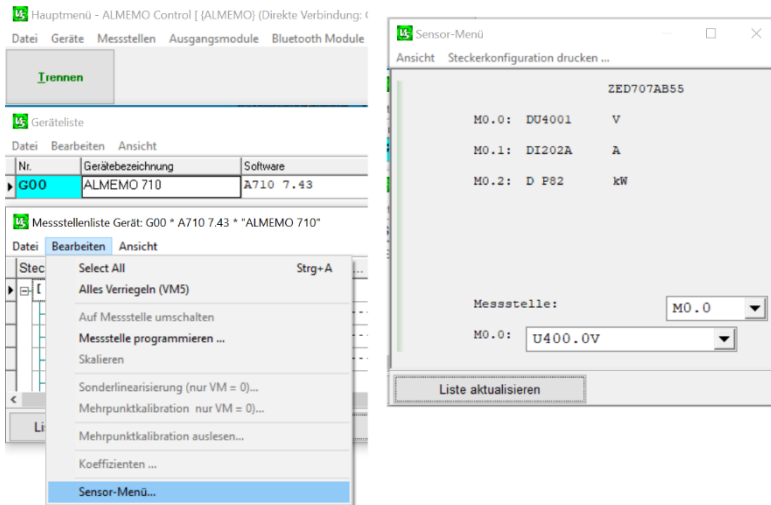

4.9 Konfiguration am PC über USB-Adapterkabel

An den PC wird der ALMEMO® D7-Fühler mit dem USB-Kupplungs-Adapterkabel ZA1919-AKUV mit einer Baudrate von 115.2 kBd direkt angeschlossen. Ein Microcontroller im Adapterkabel stellt automatisch die nötige Spannungsversorgung sowie Baudrate und Geräteadresse des Fühlers ein.

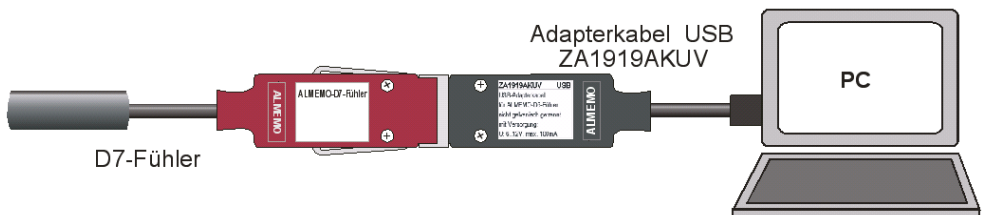

4 Produkt

Zur Konfiguration über das Sensormenü dient das Programm ALMEMO® Control (ab V. 5.14.0.330). In der Messstellenliste findet man dafür unter 'Bearbeiten' das 'Sensor-Menü'. Hier können in erster Linie bis zu 10 Messstellen mit den spezifischen D7-Messbereichen des D7-Fühlers und weitere Einstellungen programmiert werden. Die Messbereiche erscheinen auf der Schnittstelle mit neuen aussagekräftigen Kürzeln. Außer dem Bereich wird automatisch eine bis zu 6-stellige Dimension und ein Kommentar programmiert und danach der Kanal mit 5 verriegelt.

Das Löschen von Bereichen erfolgt in der Liste durch Anwahl von '- - - -'.

Funktionskanäle sind entweder Parameter des Messgerätes oder werden vom Messgerät berechnet. Sie lassen sich deshalb nur vom Gerät programmieren und nutzen. Folgende Funktionskanäle stehen zur Verfügung:

Batt, Mess, Alm, Diff, Max, Min, M(t), n(t), M(n), Flow, Time

Bei Anschluss direkt am PC sind sie nicht verwendbar. Im Kommentar erscheint dann der Hinweis 'unusable'.

5 Messungen mit dem Messmodul durchführen



Achten Sie beim Anschluss des Messmoduls auf den Messbereich, der auf dem Typenschild angegeben ist.



Wenn Sie den Steckdosenadapter als Hilfsmittel zur Messung von Spannung, Strom und Leistung an Stromkreisen, die elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind, nutzen möchten, achten Sie auf die Hinweise in Kapitel 6 Steckdosenadapter nutzen.



Das Messmodul besitzt einen ALMEMO® D7-Stecker, in dem der Messbereich und die Dimension fest programmiert sind. Dadurch wird es von jedem ALMEMO® V7-Messgerät automatisch erkannt. Es müssen vor der Verwendung keine Programmierungen vorgenommen werden.

5.1 Spannung DC mit dem Modul ZED7 00-ABx messen



Verkabeln Sie (insbesondere bei Messspannungen über 50V) im spannungsfreien Zustand. Schalten Sie die Spannung erst danach ein.



Berühren Sie im Betrieb keine freiliegenden Teile oder Anschlüsse, um elektrische Schläge zu vermeiden.




Verwenden Sie die mitgelieferten berührungsgeschützten Anschlusskabel.

1. Schalten Sie die Spannung an der Spannungsquelle ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
2. Stecken Sie den ALMEMO® Stecker des Messmoduls in eine ALMEMO® Eingangsbuchse des ALMEMO® Messgerätes.
3. Schalten Sie das ALMEMO® Messgerät ein.
4. Verbinden Sie die Spannungsquelle mithilfe der Anschlusskabel mit den Buchsen des Messmoduls, wobei das rote Anschlusskabel mit dem Pluspol und der roten Buchse verbunden werden muss.

5 Messungen mit dem Messmodul durchführen

- Schalten Sie die Spannung an der Spannungsquelle ein.
- Die Messwerte werden am ALMEMO® Messgerät angezeigt.

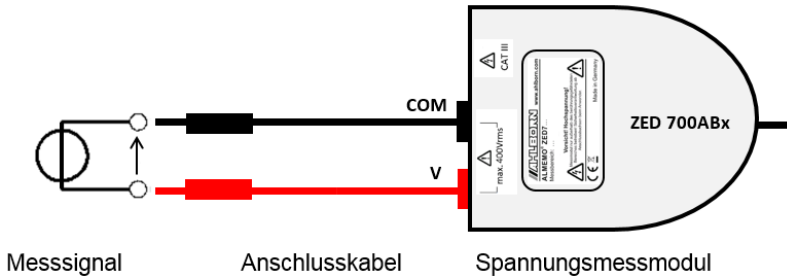

5.2 Stromstärke DC mit dem Modul ZED7 01-ABx messen

Der geräteinterne Strommesspfad ist bei Strömen größer als 10A nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Eine Messung darf in diesem Fall maximal für die Dauer von 10 Minuten durchgeführt werden. Danach muss eine Abkühlung des Gerätes auf Raumtemperatur erfolgen.



Verkabeln Sie (insbesondere bei Messspannungen über 50V) im spannungsfreien Zustand. Schalten Sie die Spannung erst danach ein.



Berühren Sie im Betrieb keine freiliegenden Teile oder Anschlüsse, um elektrische Schläge zu vermeiden.




Verwenden Sie die mitgelieferten berührungsgeschützten Anschlusskabel.



Schließen Sie das Strommessmodul nicht ohne Verbraucher direkt an die Spannungsquelle an, weil dadurch das Modul zerstört werden kann und eine Gefahr durch Überhitzung entsteht.

- Schließen Sie einen Verbraucher an die Stromquelle an.
- Schalten Sie den Verbraucher aus, sodass kein Strom fließt und überprüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- Stecken Sie den ALMEMO® Stecker des Messmoduls in eine ALMEMO® Eingangsbuchse des ALMEMO® Messgerätes.
- Schalten Sie das ALMEMO® Messgerät ein.

- Schalten Sie das Messmodul in den Strompfad des Verbrauchers, wobei das blaue Anschlusskabel mit dem Pluspol und der blauen Buchse (A) verbunden werden muss. Das schwarze Anschlusskabel muss mit der Masse (COM) verbunden werden.

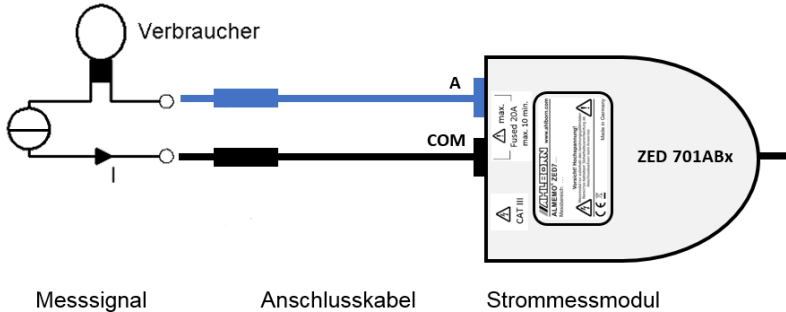

- Schalten Sie den Verbraucher ein.
 - Die Messwerte werden am ALMEMO® Messgerät angezeigt.

5.3 Leistung DC mit dem Modul ZED7 07-ABxy messen

Der geräteinterne Strommesspfad ist bei Strömen größer als 10A nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Eine Messung darf in diesem Fall maximal für die Dauer von 10 Minuten durchgeführt werden. Danach muss eine Abkühlung des Gerätes auf Raumtemperatur erfolgen.



Verkabeln Sie (insbesondere bei Messspannungen über 50V) im spannungsfreien Zustand. Schalten Sie die Spannung erst danach ein.



Berühren Sie im Betrieb keine freiliegenden Teile oder Anschlüsse, um elektrische Schläge zu vermeiden.




Verwenden Sie die mitgelieferten berührungsgeschützten Anschlusskabel.



Schließen Sie das Strommessmodul nicht ohne Verbraucher direkt an die Spannungsquelle an, weil dadurch das Modul zerstört werden kann und eine Gefahr durch Überhitzung entsteht.

5 Messungen mit dem Messmodul durchführen

- ☞ Die Spannung und die Stromstärke werden synchron gemessen und daraus die Leistung berechnet.
 1. Schließen Sie einen Verbraucher an die Stromquelle an.
 2. Schalten Sie den Verbraucher aus, sodass kein Strom fließt und überprüfen Sie die Spannungsfreiheit.
 3. Stecken Sie den ALMEMO® Stecker des Messmoduls in eine ALMEMO® Eingangsbuchse des ALMEMO® Messgerätes.
 4. Schalten Sie das ALMEMO® Messgerät ein.
 5. Schalten Sie das Messmodul in den Strompfad des Verbrauchers mithilfe des blauen Anschlusskabels (an Buchse A).
 6. Stecken Sie das schwarze Anschlusskabel an die schwarze Buchse (COM) des Messmoduls und direkt an die Spannungsquelle. Hierbei ist zu beachten, dass die schwarze Buchse (COM) das Massepotential des Messmoduls darstellt.
 7. Verbinden Sie die rote Buchse (V) mithilfe des roten Anschlusskabels direkt mit der Spannungsquelle.

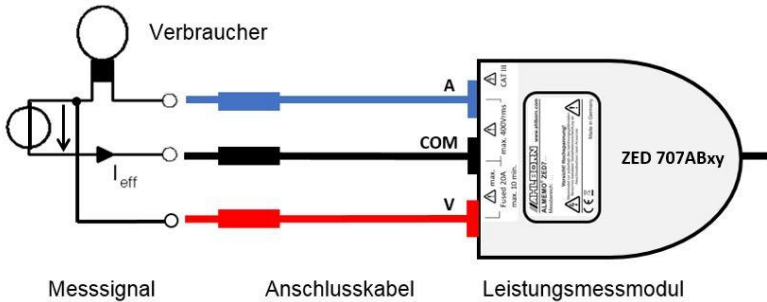

8. Schalten Sie den Verbraucher ein.
 - Die Messwerte werden am ALMEMO® Messgerät angezeigt.

5.4 Spannung AC mit dem Modul ZED7 30-ABx messen



Verkabeln Sie (insbesondere bei Messspannungen über 50V) im spannungsfreien Zustand. Schalten Sie die Spannung erst danach ein.

5 Messungen mit dem Messmodul durchführen




Berühren Sie im Betrieb keine freiliegenden Teile oder Anschlüsse, um elektrische Schläge zu vermeiden.



Verwenden Sie die mitgelieferten berührgeschützten Anschlusskabel.

1. Schalten Sie die Spannung an der Spannungsquelle ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
2. Stecken Sie den ALMEMO® Stecker des Messmoduls in eine ALMEMO® Eingangsbuchse des ALMEMO® Messgerätes.
3. Schalten Sie das ALMEMO® Messgerät ein.
4. Verbinden Sie die Spannungsquelle mithilfe der Anschlusskabel mit den Buchsen des Messmoduls.

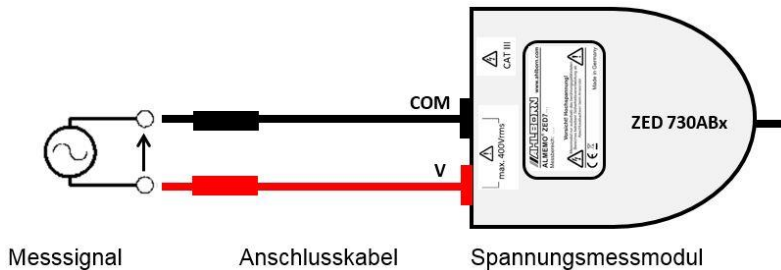

5. Schalten Sie die Spannung an der Spannungsquelle ein.
➤ Die Messwerte werden am ALMEMO® Messgerät angezeigt.

5.5 Stromstärke AC mit dem Modul ZED7 31-ABy messen



Der geräteinterne Strommesspfad ist bei Strömen größer als 10A nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Eine Messung darf in diesem Fall maximal für die Dauer von 10 Minuten durchgeführt werden. Danach muss eine Abkühlung des Gerätes auf Raumtemperatur erfolgen.



Verkabeln Sie (insbesondere bei Messspannungen über 50V) im spannungsfreien Zustand. Schalten Sie die Spannung erst danach ein.

5.6 Leistung AC mit dem Modul ZED7 37-ABxy messen



Der geräteinterne Strommesspfad ist bei Strömen größer als 10A nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Eine Messung darf in diesem Fall maximal für die Dauer von 10 Minuten durchgeführt werden. Danach muss eine Abkühlung des Gerätes auf Raumtemperatur erfolgen.



Verkabeln Sie (insbesondere bei Messspannungen über 50V) im spannungsfreien Zustand. Schalten Sie die Spannung erst danach ein.



Berühren Sie im Betrieb keine freiliegenden Teile oder Anschlüsse, um elektrische Schläge zu vermeiden.



Verwenden Sie die mitgelieferten berührungsgeschützten Anschlusskabel.




Schließen Sie das Strommessmodul nicht ohne Verbraucher direkt an die Spannungsquelle an, weil dadurch das Modul zerstört werden kann und eine Gefahr durch Überhitzung entsteht.



Die Spannung und die Stromstärke werden synchron gemessen und daraus die Wirkleistung errechnet. Des Weiteren wird die Frequenz gemessen und die Phasenverschiebung berechnet.

1. Schließen Sie einen Verbraucher an die Stromquelle an.
2. Schalten Sie den Verbraucher aus, sodass kein Strom fließt und überprüfen Sie die Spannungsfreiheit.
3. Stecken Sie den ALMEMO® Stecker des Messmoduls in eine ALMEMO® Eingangsbuchse des ALMEMO® Messgerätes.
4. Schalten Sie das ALMEMO® Messgerät ein.
5. Schalten Sie das Messmodul in den Strompfad des Verbrauchers mithilfe des blauen Anschlusskabels (an Buchse A).
6. Stecken Sie das schwarze Anschlusskabel an die mittlere Buchse (COM) des Messmoduls und direkt an die Spannungsquelle. Hierbei ist zu beachten, dass die mittlere Buchse (COM) das Massepotential des Messmoduls darstellt.
7. Verbinden Sie die rote Buchse (V) mithilfe des roten Anschlusskabels direkt mit der Spannungsquelle.

5 Messungen mit dem Messmodul durchführen

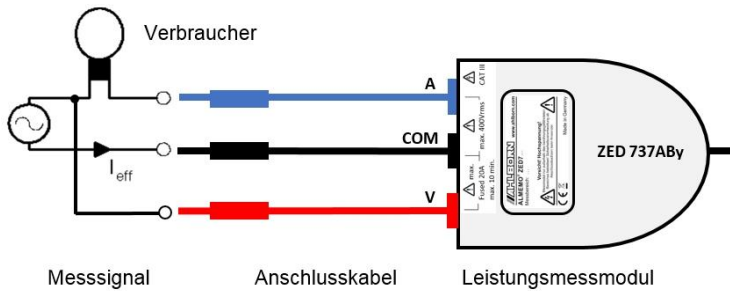

8. Schalten Sie den Verbraucher ein.

- Die Messwerte werden am ALMEMO® Messgerät angezeigt.

6 Steckdosenadapter nutzen



Beachten Sie bei der Installation des Netzadapters, dass jederzeit eine schnelle Trennung vom Stromnetz möglich sein muss.



Verkabeln Sie (insbesondere bei Messspannungen über 50V) im spannungsfreien Zustand.




Berühren Sie im Betrieb keine freiliegenden Teile oder Anschlüsse, um elektrische Schläge zu vermeiden.



Verwenden Sie die mitgelieferten berührungsgeschützten Anschlusskabel.



Achten Sie besonders darauf, dass die Strommodule immer in Reihe zum Verbraucher, d.h. in eine Zuleitung, geschaltet werden und nicht unmittelbar an die Spannungsquelle angeschlossen werden dürfen. Bei Verwendung des Steckdosenadapters sind die zugehörigen Buchsen von Steckdosenadapter und Messmodul (A-A, V-V, COM-COM) miteinander zu verbinden. Die Farbe der Buchsen ist hier zu beachten.

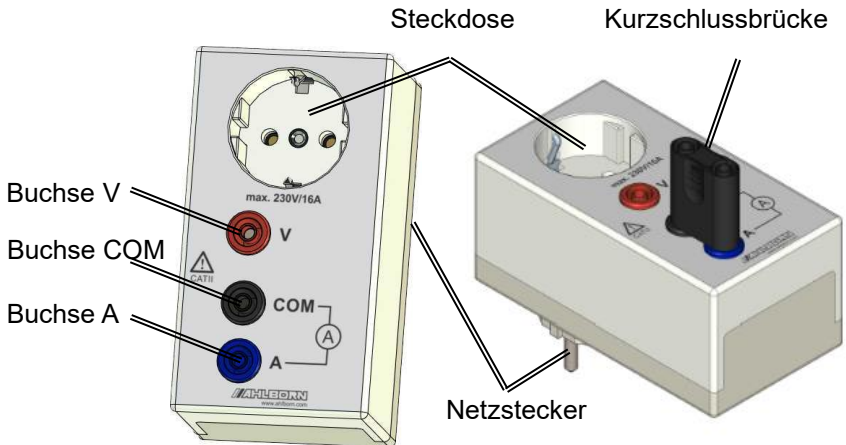


6.1 Spannungsmessung mit Steckdosenadapter

1. Stecken Sie die Kurzschlussbrücke auf die Buchsen A und COM des Steckdosenadapters.

6 Steckdosenadapter nutzen


2. Verbinden Sie das rote Anschlusskabel mit der roten Buchse (V) des Messmoduls und der roten Buchse (V) des Steckdosenadapters.
3. Verbinden Sie das schwarze Anschlusskabel mit der schwarzen Buchse (COM) des Messmoduls und der Buchse der Kurzschlussbrücke, die auf der Buchse COM des Steckdosenadapters steckt.
4. Stecken Sie den Netzstecker des Steckdosenadapters in eine Steckdose und den Netzstecker des Verbrauchers in die Steckdose des Steckdosenadapters.
5. Folgen Sie der Handlungsanleitung in Kapitel 5.1 Spannung DC mit dem Modul ZED7 00-ABx messen bzw. in Kapitel 5.4 Spannung AC mit dem Modul ZED7 30-ABx messen.

6.2 Stromstärkenmessung mit Steckdosenadapter

 Die Kurzschlussbrücke wird nicht benötigt.

1. Verbinden Sie das blaue Anschlusskabel mit der blauen Buchse (A) des Messmoduls und der blauen Buchse (A) des Steckdosenadapters.
2. Verbinden Sie das schwarze Anschlusskabel mit der schwarzen Buchse (COM) des Messmoduls und der schwarzen Buchse (COM) des Steckdosenadapters.
3. Stecken Sie den Netzstecker des Steckdosenadapters in eine Steckdose und den Netzstecker des Verbrauchers in die Steckdose des Steckdosenadapters.
4. Folgen Sie der Handlungsanleitung in Kapitel 5.2 Stromstärke DC mit dem Modul ZED7 01-ABx messen bzw. in Kapitel 5.5 Stromstärke AC mit dem Modul ZED7 31-ABx messen.

6.3 Leistungsmessung mit Steckdosenadapter

 Die Kurzschlussbrücke wird nicht benötigt.

1. Verbinden Sie das blaue Anschlusskabel mit der blauen Buchse (A) des Messmoduls und der blauen Buchse (A) des Steckdosenadapters.

2. Verbinden Sie das schwarze Anschlusskabel mit der schwarzen Buchse (COM) des Messmoduls und der schwarzen Buchse (COM) des Steckdosenadapters.
3. Verbinden Sie das rote Anschlusskabel mit der roten Buchse (V) des Messmoduls und der roten Buchse (V) des Steckdosenadapters.
4. Stecken Sie den Netzstecker des Steckdosenadapters in eine Steckdose und den Netzstecker des Verbrauchers in die Steckdose des Steckdosenadapters.
5. Folgen Sie der Handlungsanleitung in Kapitel 5.3 Leistung DC mit dem Modul ZED 707-ABx messen bzw. in Kapitel 5.6 Leistung AC mit dem Modul ZED 737-ABx messen.

7 Wartung und Pflege

Gehäuse reinigen



Die Geräte dürfen nicht vom Benutzer geöffnet werden.



Die Geräte müssen von der Stromversorgung getrennt sein.

- Reinigen Sie das Gehäuse bei Verschmutzung mit einem trockenen Tuch ohne Reinigungsmittel.

Gerät warten und reparieren



Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch die Firma Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH erfolgen.

- Senden Sie das Gerät bzw. die Geräte im Falle einer notwendigen Reparatur oder Wartung zur Service-Abteilung der Firma Ahlborn.

8 Gewährleistung

Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen des Werkes mehrere Qualitätstests. Für die einwandfreie Funktion wird eine Gewährleistung von 2 Jahren ab Auslieferungsdatum gewährt. Sollte ein Defekt vorhanden sein, verwenden Sie für den Versand möglichst das Originalverpackungsmaterial und legen Sie eine aussagekräftige Fehlerbeschreibung mit den entsprechenden Randbedingungen bei.

In folgenden Fällen ist eine Gewährleistung ausgeschlossen

- Unerlaubte Eingriffe und Veränderungen im Gerät durch den Kunden
- Betrieb außerhalb der für dieses Produkt geltenden Umgebungsbedingungen
- Verwendung von ungeeigneter Stromversorgung und Peripheriegeräten
- Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Die Änderung der Produkteigenschaften zugunsten des technischen Fortschritts oder auf Grund von neuen Bauteilen bleibt dem Hersteller vorbehalten.

9 Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss.



Dies gilt sowohl für das Produkt selbst als auch für alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Die Produkte dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

- Entsorgen Sie defekte Akkus / leere Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
- Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu. Beachten Sie dabei die lokalen Entsorgungsvorschriften.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial gemäß den landesüblichen Vorschriften.

10 Technische Daten

Messmodul

Eingangsbuchsen	Sicherheitsbuchsen CAT III, 20 A, Ø 4 mm	
Galvanische Trennung	6 kV	
Abtastrate	1 KHz intern	
Genauigkeit	0,1% v. Ew. ± 2 Digit, gültig für Ströme ≤ 10 A	
Temperaturdrift	max. 0,003 %/K (30 ppm/K), gültig für Ströme ≤ 10 A	
Nennbedingungen	23 °C ± 2 K, 10 ... 90% r.H. (nicht kondensierend)	
Einsatzbedingungen		
Arbeitstemperatur	+5 ... +40 °C	(Lagertemperatur: -20 ... +60 °C)
Umgebungsluftfeuchte	10 ... 90% r.H.	(nicht kondensierend)
Max. Höhe ü. Normalnull	2000 m	
Eingangswiderstand R_i		
Spannungsmessung	25/60 V	1 x 10 ⁶ Ohm
	400 V	4 x 10 ⁶ Ohm
Strommessung	20 mA / 200 mA	4,7 Ω / 1 Ω
	2 A / 20 A	100 mΩ / 8 mΩ
Messdauer Strommessung	Bei Strömen größer als 10 A max. 10 Minuten. Danach muss eine Abkühlung des Gerätes auf Raumtemperatur erfolgen.	
Gehäuse	ABS, Maße L127 x B83 x H42 mm	
Betriebsspannung	9 ... 12 V über ALMEMO® Gerät	
Nennstrom	max. 60 mA (Stecker und Modul)	
AC-Messung		
Betriebsbereich U, I, P	DC ... 250 Hz	
Leistungsfaktor $\cos\varphi$	0,17 ... 1 (entspricht φ : -80° ... 80°), Auflösung 0,01	
Ansprechschwelle U, I	Signal U und I > 1 % v. Ew.	
Einschwingzeit	4 Perioden (max. 200 ms, z.B. bei 50 Hz: 80 ms)	
Messbereich Frequenz	20 ... 250 Hz, Auflösung 0,01 Hz	
Messbereiche Spannung, Strom, Leistung (DC/AC)	Siehe Kapitel 4.3	

Technische Änderungen vorbehalten!

Steckdosenadapter

Eingangsbuchsen/ Kurzschlussbrücke	Sicherheitsbuchsen CAT II, 16 A, Ø 4 mm 230 V, 16 A, 50 Hz
Nennbedingungen	23 °C ± 2 K, 10 ... 90% r.H. (nicht kondensierend)
Einsatzbedingungen	
Arbeitstemperatur	+5 ... +40 °C (Lagertemperatur: -20 ... +60 °C)
Umgebungsluftfeuchte	10 ... 90% r.H. (nicht kondensierend)
Max. Höhe ü. Normalnull	2000 m
Gehäuse	ABS, Maße: L120 x B65 x H94 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Trotz großer Sorgfalt sind fehlerhafte Angaben nicht auszuschließen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Diese und weitere Bedienungsanleitungen sowie das ALMEMO® Handbuch finden Sie auf **www.ahlborn.com** im Bereich **SERVICE** unter **DOWNLOADS**

© Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH 2021

All rights reserved.

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH,
Eichenfeldstraße 1, D-83607 Holzkirchen,
Tel. +49(0)8024/3007-0, Fax +49(0)8024/30071-0
Internet: <http://www.ahlborn.com>, email: amr@ahlborn.com

BITTE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN