Capteur NiCr-Ni à poignée FTA 05 L0050H

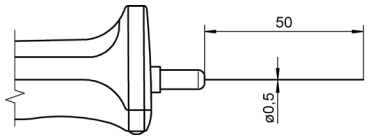

Précision : NiCr-Ni classe 1*
Pointe de mes.: Plage d'utilisation -200...+500 °C
Conducteur gainé Inconel
T_{90}: 0.8 s
Poignée: 127 mm
Câble Câble thermocouple 1.5 m
FEP / silicone**

pour mesure en immersion — L = 50 mm — **Référence FTA05L0050H**

Capteur NiCr-Ni à poignée FTA 125 LxxxxH

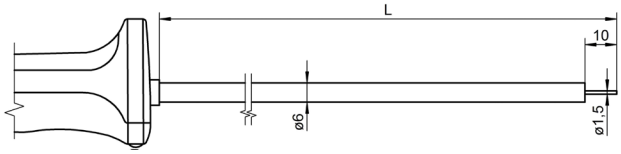

Précision : NiCr-Ni classe 1*
Pointe de mes.: Plage d'utilisation -200...+800 °C
Conducteur gainé Inconel
T_{90}: 1.5 s
Poignée: 127 mm
Câble: Câble thermocouple 1.5 m
FEP / silicone**

pour mesure en immersion — L = 300 mm — **Référence FTA125L0300H**

Capteur NiCr-Ni à poignée FTA 126 LxxxxH

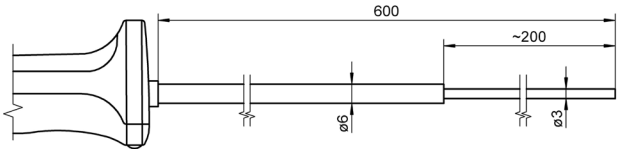

Précision : NiCr-Ni classe 1*
Pointe de mes.: Plage d'utilisation -200...+800 °C
Conducteur gainé Inconel
T_{90}: 2.5 s
Poignée: 127 mm
Câble Câble thermocouple 1.5 m
FEP / silicone**

pour mesure en immersion — L = 600 mm — **Référence FTA126L0600H**

Capteur NiCr-Ni à poignée FTA 1261 LxxxxH

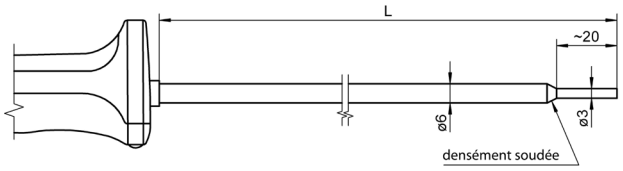

Précision : NiCr-Ni classe 1*
Pointe de mes.: Plage d'utilisation -200...+500 °C
Conducteur gainé Inconel
T_{90}: 3 s
Poignée: 127 mm
Câble Câble thermocouple 1.5 m
FEP / silicone**

pour les mesures en immersion dans les milieux plastiques, pâteux p. ex. les bitumes
L = 150 mm — **Référence FTA1261L0150H**
L = 300 mm — **Référence FTA1261L0300H**

* plage de validité voir début de chapitre
** pas d'influence de température sur la jonction entre l'élément de mesure et le câble (voir début de chapitre)

Étalonnage accrédité DAkkS ou étalonnage en usine KT90xx, température, pour capteur ou chaîne de mesure (capteur+appareil), voir chapitre Certificats d'étalonnage. L'étalonnage accrédité DAkkS satisfait aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 relative aux activités d'essai.

11/2026 • Sous réserve d'erreurs et de modifications

Capteur NiCr-Ni à poignée FTA 123 LxxxxH

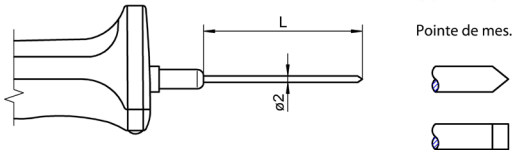

pour les mesures en immersion dans les milieux plastiques, pâteux

Précision :	NiCr-Ni classe 1*
Pointe de mes.:	Plage d'utilisation -200...+300 °C à aiguille
T_{90}:	3 s
Poignée:	127 mm
Câble:	Câble thermocouple 1.5 m FEP / silicone**

L = 50 mm **Référence FTA123L0050H**
L = 100 mm **Référence FTA123L0100H**

Capteur NiCr-Ni à poignée FTA 1231 LxxxxH

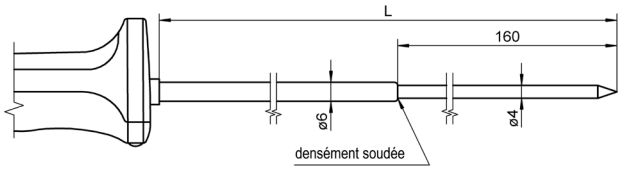

pour les mesures en immersion dans les milieux plastiques, pâteux

Précision :	NiCr-Ni classe 1*
Pointe de mes.:	Plage d'utilisation -200...+400 °C à aiguille, quilles inox 1.4541
T_{90}:	6 s
Poignée:	127 mm
Câble:	Câble thermocouple 1.5 m FEP / silicone**

L = 250 mm **Référence FTA1231L0250H**

* plage de validité voir début de chapitre
** pas d'influence de température sur la jonction entre l'élément de mesure et le câble (voir début de chapitre)

Étalonnage accrédité DAkkS ou étalonnage en usine KT90xx, température, pour capteur ou chaîne de mesure (capteur+appareil), voir chapitre Certificats d'étalonnage. L'étalonnage accrédité DAkkS satisfait aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 relative aux activités d'essai.